PRODUCTOS PARA LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA · APLICACIÓN

Moldeo por inyección médico: recogida y clasificación con SE-DCB-110

Las piezas de grado médico expulsadas del molde se deslizan por rampas de recogida hasta los contenedores, y la fricción las carga fuertemente. Las piezas cargadas atraen polvo y fibras (inaceptable en la producción estéril), se adhieren a la rampa metálica y entre sí, de modo que no pueden contarse ni clasificarse automáticamente, y provocan descargas dolorosas a los operarios en el contenedor. Una SE-DCB-110 directamente sobre la rampa de descarga inunda las piezas de iones equilibrados cuando salen de la máquina: se deslizan limpiamente al contenedor, quedan libres de polvo y pueden manipularse con seguridad. Arrastre para girar; pellizque o use la rueda para ampliar.

SIN IONIZACIÓN

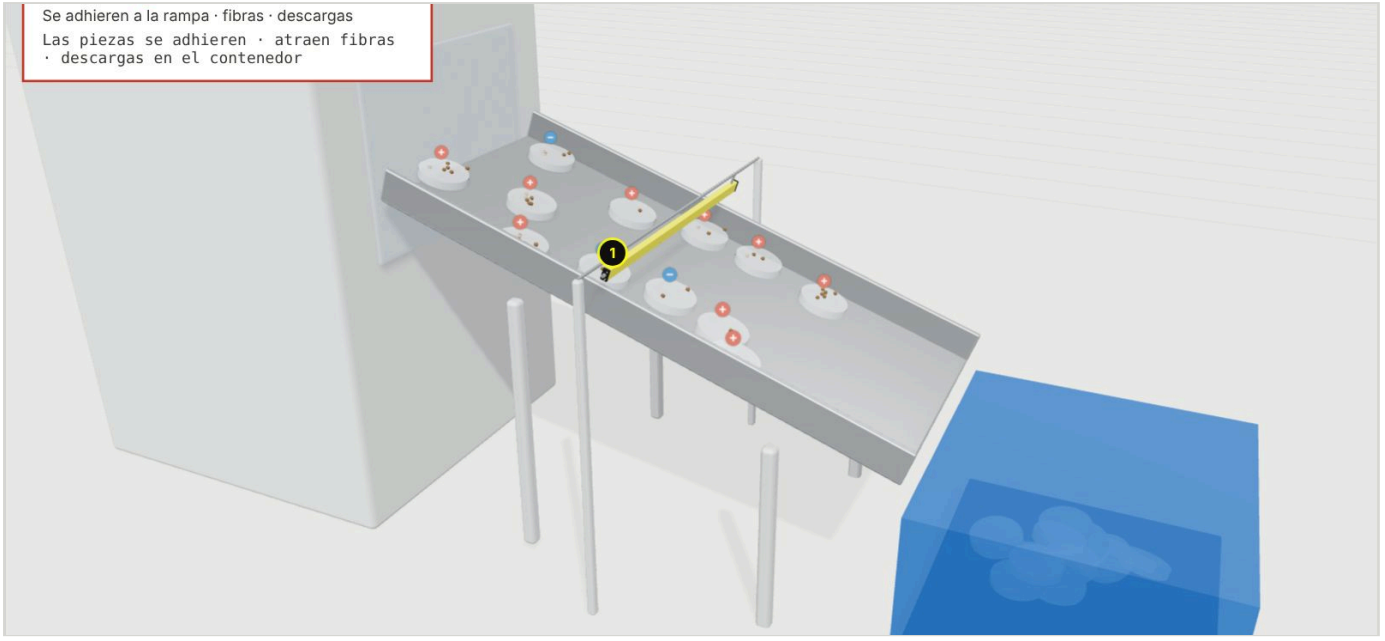

CON SE-DCB-110

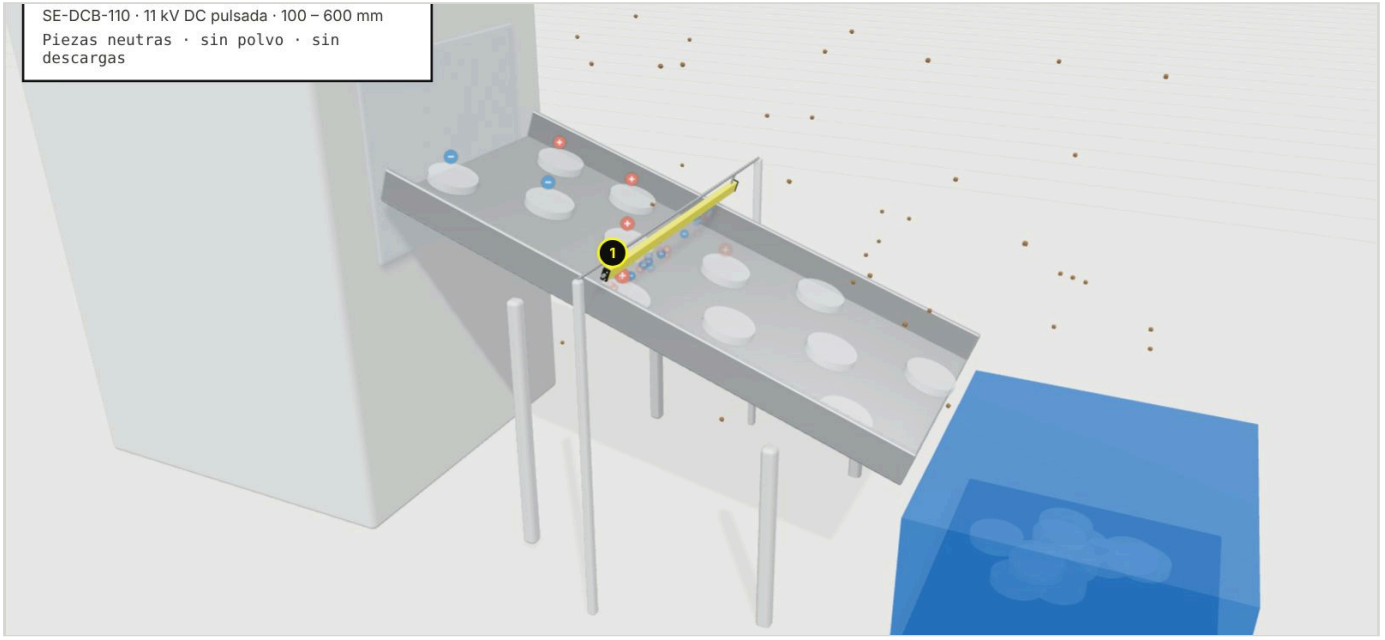

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Producto FÖGE en esta aplicación

1 · SE-DCB-110 — sobre la rampa de descarga

Sobre la rampa justo después de la salida de la máquina; las puntas apuntan a las piezas que se deslizan.

Ionización	**11 kV DC pulsada · sin descargas**
Alcance de ionización	**100 – 600 mm**
Longitud de pedido	**300 – 4500 mm (pasos de 100 mm)**
Alimentación	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

Detalles de SE-DCB-110 **Solicitar presupuesto técnico**

Modelo 3D interactivo: cambie entre ambos estados, gire y amplíe. **foge-antistatic.com/es/applications/medical-chute-se-dcb-110/**

Modelo esquemático, no a escala. Las máquinas y piezas son genéricas, sin fabricante ni marca concretos. Datos de producto según lo publicado en foge-antistatic.com/es.

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.