STATIKUS ELEKTROMOSSÁG TERMÉKEK · ALKALMAZÁS

Orvosi fröccsöntés — gyűjtés és válogatás SE-DCB-110 rúddal

A szerszámból kiadott orvosi minőségű alkatrészek gyűjtőcsúszdákon csúsznak a ládákba — a súrlódás erősen feltölti őket. A feltöltött alkatrészek magukhoz vonzzák a port és a szálakat (steril gyártásban elfogadhatatlan), a fémcsúszdához és egymáshoz tapadnak, így automatikusan nem számlálhatók és nem válogathatók, a ládánál pedig fájdalmas kisüléseket okoznak a kezelőknek. A kiadócsúszda fölött közvetlenül elhelyezett SE-DCB-110 kiegyensúlyozott ionokkal árasztja el az alkatrészeket, ahogy elhagyják a gépet: tisztán csúsznak a ládába, pormentesek maradnak, és biztonságosan kezelhetők. Forgatáshoz húzza, nagyításhoz csippentsen vagy görgessen.

IONIZÁCIÓ NÉLKÜL

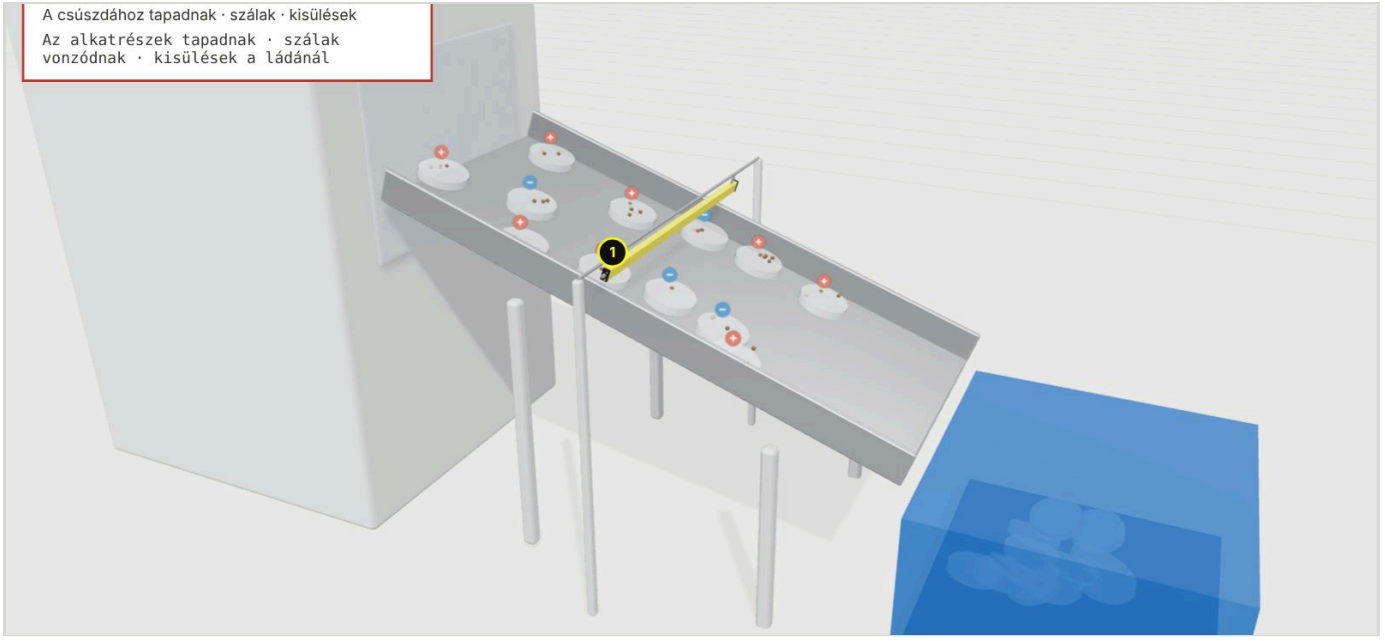

SE-DCB-110 KÉSZÜLÉKKEL

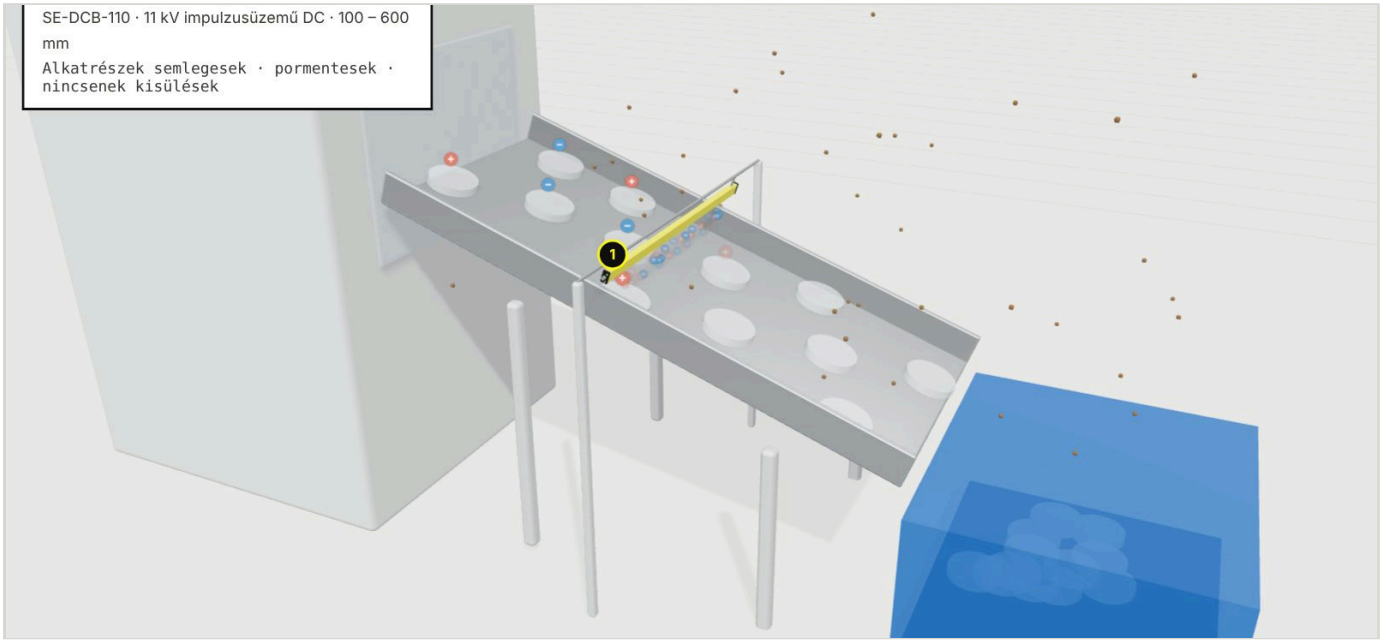

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

FÖGE termék ebben az alkalmazásban

1 · SE-DCB-110 — a kiadócsúszda fölött

A csúszda fölött keresztben, közvetlenül a gép kimenete után; a tűk az elhaladó alkatrészek felé néznek.

Ionizáció	**11 kV impulzusüzemű DC · kisülésmentes**
Ionizációs hatótávolság	**100 – 600 mm**
Rendelési hossz	**300 – 4500 mm (100 mm-es lépésekben)**
Tápellátás	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 részletei **Műszaki árajánlat kérése**

Interaktív 3D modell: állapotok váltása, forgatás és nagyítás. **foge-antistatic.com/hu/applications/medical-chute-se-dcb-110/**

Sematikus modell, nem méretarányos. A gépek és alkatrészek általánosak, konkrét gyártó vagy márka nélkül. A termékadatok a következő oldalon közzétetteknek felelnek meg: foge-antistatic.com/hu.

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.